




Arquivo Digital Fiorilli Software S/C

O arquivo digital com a Cotação ou Proposta é enviado pela Entidade através de e-mail ou disponibilizado em seu site para baixa-lo.

Para que interessado possua o Aplicativo, basta que esse acesse www.fiorilli.com.br/cotacao.exe que o aplicativo é baixado automaticamente conforme tela abaixo:

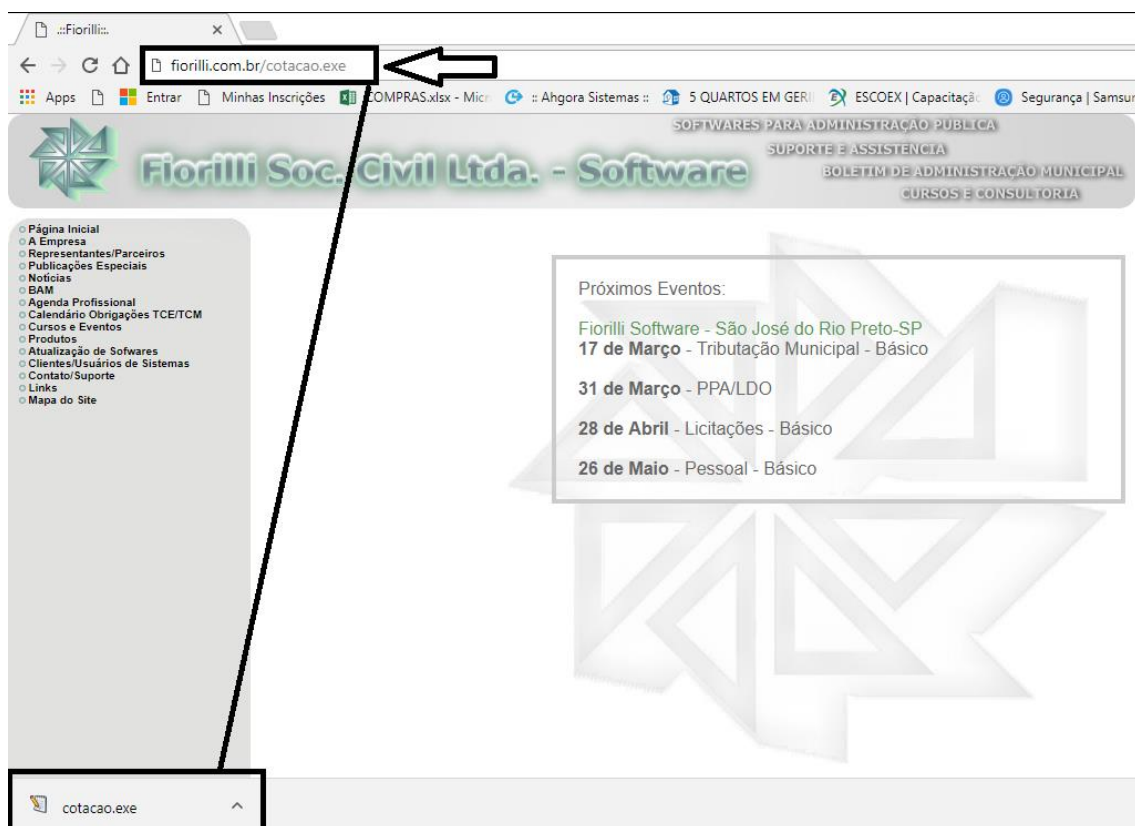

Após baixar o arquivo é só executar o mesmo para que possa carregar o arquivo de proposta enviado pela Entidade conforme as 3 telas abaixo:

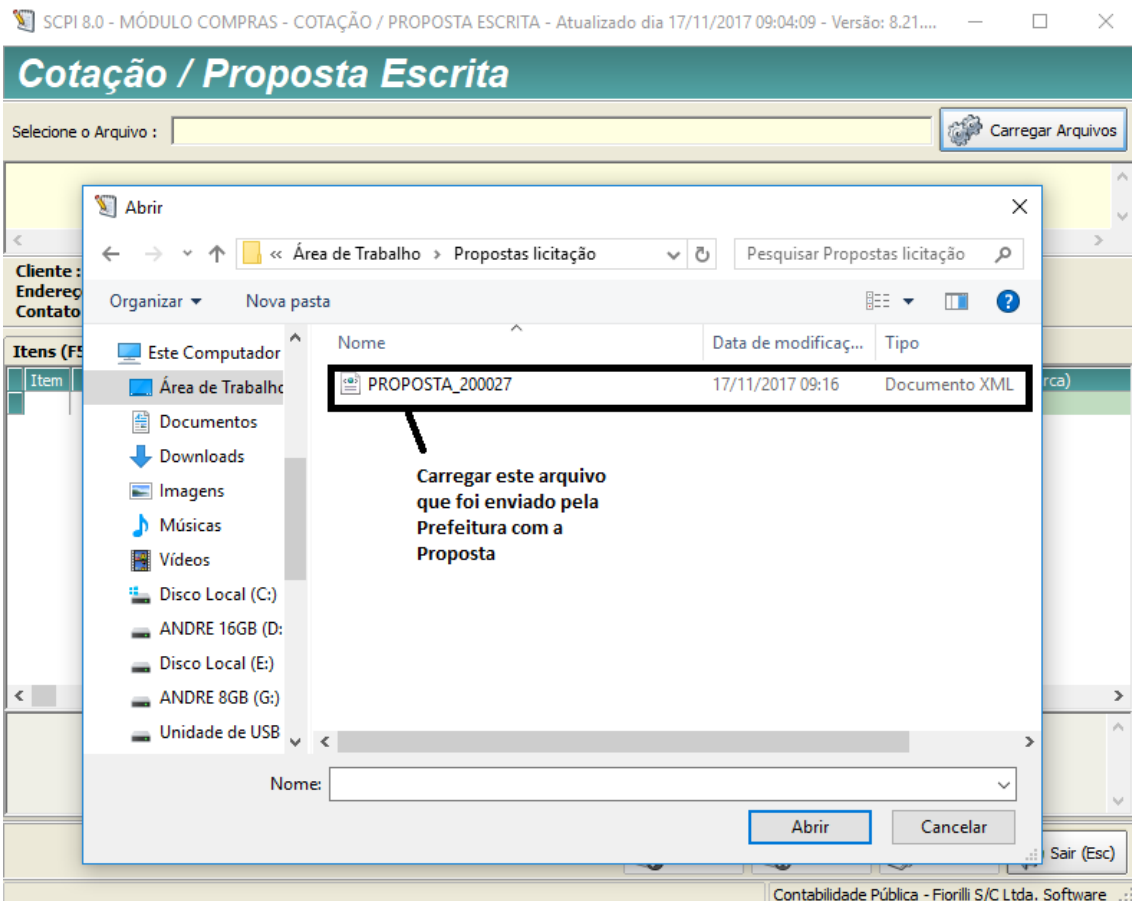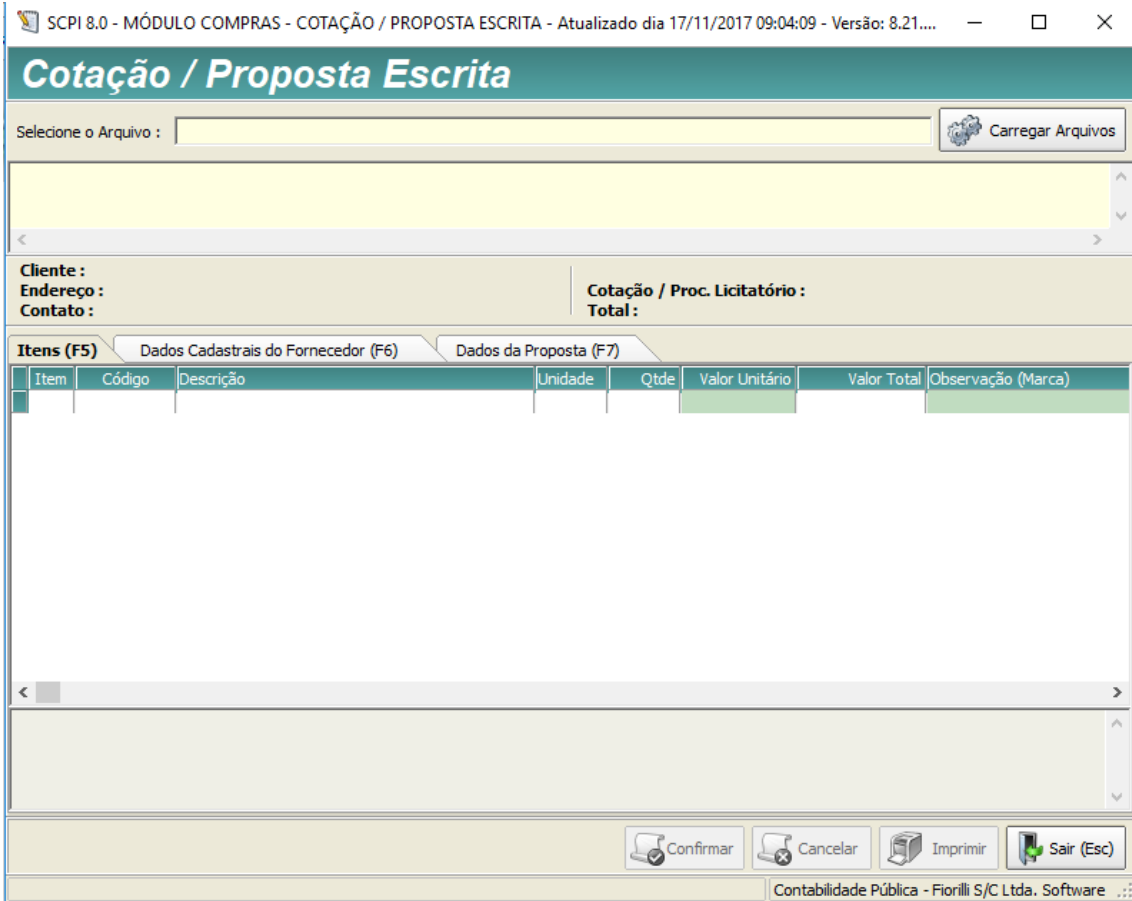

SCPI 8.0 - MÓDULO COMPRAS - COTAÇÃO / PROPOSTA ESCRITA - Atualizado dia 17/11/2017 09:04:09 - Versão: 8.21....

Cotação / Proposta Escrita

Selecione o Arquivo : C:\Users\André Pereira\Desktop\Propostas licitação\PROPOSTA_200027.XML Carregar Arquivos

Proc. Licitatório: 200027/17 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 73 Sessão: 1
 Realização: 24/11/2017 08:00 - Sala de Reuniões
 Aquisição de Materiais Laboratoriais

Cliente : MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
Endereço : RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 - JD SAO BENT
Contato : **Cotação / Proc. Licitatório : 200027/17**
Total : R\$ 0,00

Itens (F5) Dados Cadastrais do Fornecedor (F6) Dados da Proposta (F7)

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Observação (Marca)
1	028.003.420	ÁCIDO ÚRICO (UOD-PAP) -	KT	18	0,00	0,00	
2	028.003.419	ADESIVO HIPOALÉRGICOS REDONDO	CX	60	0,00	0,00	
3	028.003.182	ASO (LÁTEX)	KT	10	0,00	0,00	
4	028.003.391	BHCG TESTE RÁPIDO EM TIRAS	CX	12	0,00	0,00	
5	028.003.421	COLESTEROL HDL -	KT	18	0,00	0,00	
6	028.003.422	COLESTEROL TOTAL (COD-PAP)-	KT	50	0,00	0,00	
7	028.003.434	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX -	UN	2.000	0,00	0,00	
8	027.027.011	COLETOR DE URINA UNIVERSAL	CX	10.000	0,00	0,00	
9	028.003.396	COLORAÇÃO DE ZIEHL NELSSEN	KT	4	0,00	0,00	
10	028.003.397	COLORAÇÃO PANÓTICA HEMOGRAMA RÁPIDO	KT	2	0,00	0,00	
11	028.003.398	COLUNA PARA DEIONIZADOR COMPATÍVEL PARA E	UN	3	0,00	0,00	
12	028.003.440	CONTADOR E DIFERENCIADOPR DE CELULAS HEM	UN	1	0,00	0,00	

ÁCIDO ÚRICO (UOD-PAP) - Método enzimático colorimétrico para a determinação do Ácido Úrico. Conjunto para 200 determinações de ácido úrico, contendo: 1. Reagente Enzimático: 02 frascos com 100 mL cada, de solução aquosa contendo tampão pH 7,20, Uricase 3 120 U/L, Peroxidase 3 1000 U/L, 4-aminoantipirina 1,0 mmol/L, TOOS 0,60 mmol/L e azidasódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Padrão: 01 frasco com 5,0 mL, contendo ácido úrico 8 mg/dL (0,476 mmol/L) em solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dL. Com protocolo de automação semelhante a Labtest/Gold Analisa. Conservar entre 2 e 8°C. Validade no mínimo de 18 meses. Kit

Contabilidade Pública - Fiorilli S/C Ltda. Software

Após o preenchimento da proposta é só confirmar que o sistema gera um arquivo de retorno com a palavra **RET** na mesma pasta onde foi salvo a proposta inicial conforme tela abaixo:

SCPI 8.0 - MÓDULO COMPRAS - COTAÇÃO / PROPOSTA ESCRITA - Atualizado dia 17/11/2017 09:04:09 - Versão: 8.21....

Cotação / Proposta Escrita

Selecione o Arquivo : C:\Users\André Pereira\Desktop\Propostas licitação\RET_PROPOSTA_200027.XML Carregar Arquivos

Proc. Licitatório: 200027/17 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Modalidade: 73 Sessão: 1
 Realização: 24/11/2017 08:00 - Sala de Reuniões
 Aquisição de Materiais Laboratoriais

Cliente : MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO
Endereço : RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098 - JD SAO BENT
Contato : **Cotação / Proc. Licitatório : 200027/17**
Total : R\$ 89.332,00

Itens (F5) Dados Cadastrais do Fornecedor (F6) Dados da Proposta (F7)

Item	Código	Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Observação (Marca)
1	028.003.420	ÁCIDO ÚRICO (UOD-PAP) -	KT	18	1,00	18,00	
2	028.003.419	ADESIVO HIPOALÉRGICOS REDONDO	CX	60	1,00	60,00	
3	028.003.182	ASO (LÁTEX)	KT	10	1,00	10,00	
4	028.003.391	BHCG TESTE RÁPIDO EM TIRAS	CX	12	1,00	12,00	
5	028.003.421	COLESTEROL HDL -	KT	18	1,00	18,00	
6	028.003.422	COLESTEROL TOTAL (COD-PAP)-	KT	50	1,00	50,00	
7	028.003.434	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX -	UN	2.000	1,00	2.000,00	
8	027.027.011	COLETOR DE URINA UNIVERSAL	CX	10.000	1,00	10.000,00	
9	028.003.396	COLORAÇÃO DE ZIEHL NELSSEN	KT	4	0,00	0,00	
10	028.003.397	COLORAÇÃO PANÓTICA HEMOGRAMA RÁPIDO	KT	2	1,00	2,00	
11	028.003.398	COLUNA PARA DEIONIZADOR COMPATÍVEL PARA E	UN	3	1,00	3,00	
12	028.003.440	CONTADOR E DIFERENCIADOPR DE CELULAS HEM	UN	1	1,00	1,00	

ÁCIDO ÚRICO (UOD-PAP) - Método enzimático colorimétrico para a determinação do Ácido Úrico. Conjunto para 200 determinações de ácido úrico, contendo: 1. Reagente Enzimático: 02 frascos com 100 mL cada, de solução aquosa contendo tampão pH 7,20, Uricase 3 120 U/L, Peroxidase 3 1000 U/L, 4-aminoantipirina 1,0 mmol/L, TOOS 0,60 mmol/L e azidasódica 0,1 g/dL. Conservar entre 2 e 8°C. 2. Padrão: 01 frasco com 5,0 mL, contendo ácido úrico 8 mg/dL (0,476 mmol/L) em solução aquosa e azida sódica 0,1 g/dL. Com protocolo de automação semelhante a Labtest/Gold Analisa. Conservar entre 2 e 8°C. Validade no mínimo de 18 meses. Kit

Contabilidade Pública - Fiorilli S/C Ltda. Software

Após essas etapas a proposta de preços por parte do fornecedor está encerrada, bastando apenas devolvê-la à entidade pública. Isto poderá ser feito da mesma maneira como foi recebido, ficando acordado entre as partes participantes (entidade e fornecedor). O mesmo arquivo recebido, após preenchido e salvo, deverá ser retornado ao órgão público. Este é o procedimento de uso do sistema.

Dúvidas e informações adicionais, tais como práticas de utilização da ferramenta poderão ser retiradas com a entidade solicitante.

Atenciosamente,

Fiorilli Software S/C